


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

CENTRE NATIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINE

DIRECTION GENERALE

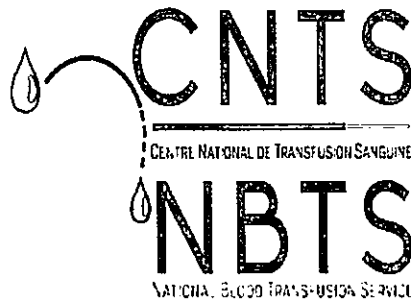

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

NATIONAL BLOOD
TRANSFUSION
SERVICE

HEAD OFFICE

AVIS DE LA DEMANDE DE COTATION N°.....03...../ADC/CNTS/DG/SM/CIPM
DU.....29 JUL 2024..... POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES
ÉQUIPEMENTS DE PRÉPARATION DES PRODUITS SANGUINS AU CENTRE NATIONAL
DE TRANSFUSION SANGUINE,

« EN PROCEDURE D'URGENCE ».

1. Objet de la Demande de Cotation

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation consistent en la fourniture et l'installation des équipements de préparation des produits sanguins au Centre National de Transfusion Sanguine de Yaoundé.

2. Consistance des prestations

Les fournitures, objets de la présente consultation ne sont pas alloties et consistent en la fourniture et l'installation des équipements de préparation des produits sanguins comme suit :

- a) Un (01) Bain marie thermostaté ;
- b) Deux (02) Séparateurs manuels semi-automatiques ;
- c) Un (01) Microscope Trinoculaire LED ;
- d) Trois (03) Micropipettes : 10-100 microns (01), 100-200 microns (01), 500-1000 microns (01) ;
- e) Un (01) Réfrigérateur banque de sang ;
- f) Un (01) Congélateur de plasma
- g) Un (01) Agitateur de plaquettes avec armoire ;
- h) Deux (02) Soudeuses des tubulures de poche de sang fixes ;
- i) Deux (02) Soudeuses des tubulures de poche de sang mobiles ;
- j) Trois (03) Hemo-mixer.


3. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans la fabrication ou la fourniture des équipements de même nature.

4. Financement

Les prestations, objet de la présente demande de cotation seront financées par le Budget d'Investissement du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) exercice 2024
l'Imputation 58-40-047-06-350039-464110.

5. Mode de soumission

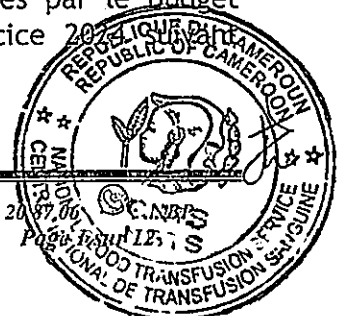

Le mode de soumission retenu pour cette demande de Cotation est hors ligne.

6. Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier physique peut être consulté gratuitement au service des marchés du Centre National de Transfusion Sanguine, sis à Avenue Jean Paul II avant le rond-point bastos à Yaoundé, Tél./Fax : 222 208 706/ 696 911 678, dès publication du présent avis. Il peut également être consulté en ligne aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

7. Acquisition du dossier de Demande de Cotation

La version physique du dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au service des marchés du Centre National de Transfusion Sanguine, sis à Avenue Jean Paul II avant le rond-point bastos à Yaoundé, Tél./Fax : 222 208 706/ 696 911 678, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable des frais d'achat du DC de trente-cinq mille (35 000) Francs CFA, payable dans le compte numéro 33598860001-94 intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » domicilié à la BICEC - Cameroun. Il est également possible d'obtenir la version électronique du dossier de Demande de Cotation (DC) par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique.

8. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de Trente-cinq millions (35 000 000) F CFA Toutes Taxes Comprises.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 12 du DDC dont le montant s'élève à sept cent mille (700.000) francs CFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des s publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.


10. Remise des Cotations

Chaque cotation est rédigée en français ou en anglais. - Pour la soumission hors ligne, la cotation en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des marchés du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), sis à Yaoundé, avant le rond-point bastos lieu-dit avenue Jean Paul II B.P. : 33 165 Yaoundé - Tél. : +237 222 208 706 -, au plus tard le ... à 11 heures précises et devra porter la mention :

AVIS DE LA DEMANDE DE COTATION N°03...../DC/CNTS/DG/SM/CIPM/ 2024..... DU
POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE PRÉPARATION DES
PRODUITS SANGUINS AU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE, EN
PROCEDURE D'URGENCE.

« A N'OUVRIER QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Ouverture des plis

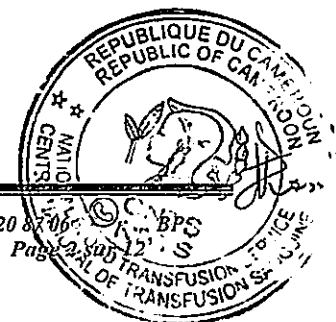

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 26 aout 2024 à 12 heures par la commission Interne de passation des marchés du Centre National de Transfusion Sanguine dans la salle affectée aux travaux de cet organe d'appui technique sis à Yaoundé, avant le rond-point bastos lieu-dit avenue Jean Paul II B.P. : 33 165 Yaoundé - Tél. : +237 222 208 706.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de Cotation.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

L'ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des cotations fixée dans le Dossier de Demande de Cotation.

12. Recevabilité des Cotations

Les pièces administratives, la cotation technique et la cotation financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé. Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission.
- les plis sans indication de l'identité de la Demande de Cotation ;
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans la DC ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions de la DC sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces de la DC, entraînera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.


13. Critères d'évaluations

Les critères d'évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels¹. Un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel.

13.1-Critères éliminatoires


Il s'agit notamment :

- i. Dossier administratif incomplet ou non conforme après épuisement du délai réglementaire de 48 heures ;

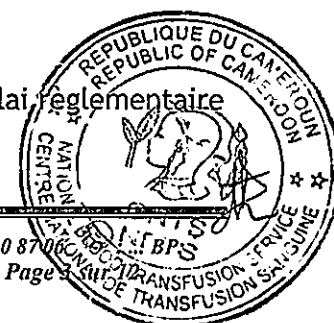

- ii. Absence ou la non-conformité de la caution de soumission ;
- iii. Absence de la déclaration sur l'honneur de non-abandon d'un marché au cours des trois dernières années ;
- iv. fausses déclarations, les manœuvres frauduleuses ou la falsification de pièces ;
- v. non-respect de 80 % des critères essentiels ;
- vi. absence d'un prix unitaire quantifié dans la cotation ;
- vii. absence d'un élément de l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;
- viii. non-conformité du modèle de soumission ;
- ix. absence de prospectus en couleur accompagné des fiches techniques du fabricant ;
- x. absence de l'agrément du MINSANTE ;
- xi. absence du certificat d'origine ou autorisation du fabricant ;
- xii. non-conformité du mode de soumission ;
- xiii. absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
- xiv. absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;
- xv. non acceptation des clauses de la lettre-commande ;
- xvi. non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture :

| N° | DESIGNATIONS | Spécifications techniques majeures |
|----|--|---|
| 1 | 01 Bain marie thermostaté | Cyclotron Frequency Range 0: 20-300rpm/min Température Range : RT-100°C |
| 2 | 02 Séparateurs de plasma | Volume des poches : 100- 400ml |
| 3 | 01 Microscope trinoculaire LED | Trinocular microscope (à 03 têtes) |
| 4 | 03 Micropipettes : 10-100 microns (01), 20-200 microns (01), 100-1000 microns (01) | Volume de 10 à 100 µl |
| | | Volume de 20 à 200 µl |
| | | Volume de 100 à 1000 µl |
| 5 | 01 Réfrigérateur banque de sang | Température de consigne : 4±2°C |
| | | Précision : 0.1°C |
| | | Alarme basse / haute température |
| | | Contrôle du système par microprocesseur |
| 6 | 01 Congélateur de plasma | Congélateur de plasma 528 L |
| | | Variation de température haute inférieur ou égale -20°C température basse -40 °C |
| 7 | 01 Agitateur de plaquettes avec armoire | Variation de Température : 22 °C ± 2 °C. |
| | | Erreur d'affichage de la température : ± 1 °C |
| | | Porte : porte unique |
| 8 | 02 Soudeuses des tubulures de poche de sang fixes | Soudure des poches à sang en évitant l'hémolyse |
| | | Type de scellage : Automatique |
| 9 | | Pince à souder avec câble et chargeur de batterie |

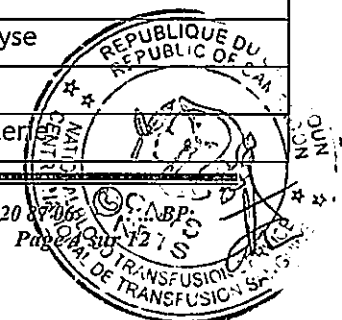

| | | |
|----|---|--|
| | 02 Soudeuses des tubulures de poche de sang mobiles | Autonomie : 1000 soudures |
| 10 | 03 Hemo-mixer | volume de prélèvement sanguin personnalisé Plage de mesure : 0-1200ml |

13.2-Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

1. la présentation de l'offre ;
2. L'expérience dans les prestations similaires ;
3. le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, atelier de réparation, personnel technique), le cas échéant ;
4. L'Attestation de capacité financière au moins égale au Coût prévisionnel TTC de la demande de cotation, délivrée par une banque agréée de 1er ordre ;
5. Le Planning et délai de livraison ne dépassant pas soixante (60) jours ;
6. la garantie d'au moins six (06) mois

14. Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de **soixante (60) jours calendaires**. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

15. Tranches/Allotissement

Les prestations objets de la présente Demande de Cotation ne sont ni subdivisés ni alloties.

16. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera la lettre commande au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

17. Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant **soixante (60) jours** à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.


18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Service des marchés du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), sis à Yaoundé, avant le rond-point bastos lieu-dit avenue Jean Paul II B.P. : 33 165 Yaoundé - Tél. : +237 222 208 706, ou en ligne aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 07 48 07 48


Yaoundé, le 29 ^{juin} 2022

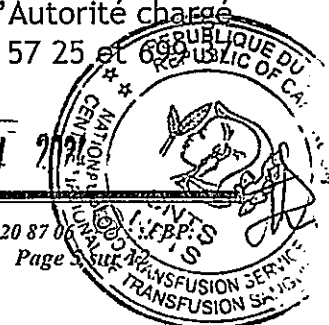

Le Directeur Général

AMPLIATIONS

- MINMAP/ APCR ;
- ARMP pour insertion au JDM;
- Président/CIPM/info ;
- Affichage ;
- Chrono/Archives.

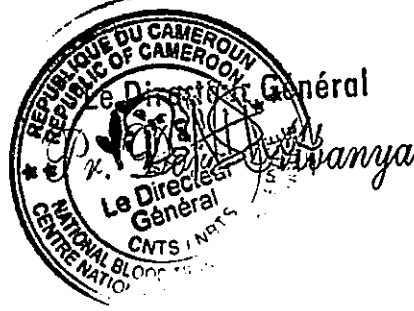

NOTICE OF REQUEST FOR QUOTATION IN EMERGENCY PROCEDURE NO
03 /ADC/NBTS/GM/PCS/ITB OF 20 2024 2024 FOR THE SUPPLY
AND INSTALLATION OF BLOOD PROCESSING EQUIPMENT AT THE NATIONAL BLOOD
TRANSFUSION SERVICE.

1. Subject of the Request for Quotation

The services that are subject to this Request for Quotation consist in the supply and installation of blood processing equipment at the National Blood Transfusion Service in Yaounde.

2. Nature of Services

The supplies, which are the subject of this consultation, are not allocated and consist of the supply and installation of blood processing equipment, broken down as follow :

- k) One (01) Thermostatically controlled water bath/bain-marie ;
- l) Two (02) Semi-automatic manual separators ;
- m) One (01) LED Trinocular Microscope ;
- n) Three (03) Micropipettes : 10-100 microns (01), 100-200 microns (01), 500-1000 microns (01) ;
- o) One (01) Blood Bank Refrigerator ;
- p) One (01) Plasma freezer ;
- q) One (01) Platelet agitator with cabinet ;
- r) Two (02) Fixed blood bag tube welders ;
- s) Two (02) mobile blood bag tube welders ;
- t) Three (03) Hemo-mixers.

3. Participation and origin

Participation in this consultation notice is open to companies incorporated under Cameroonian law specialised in the manufacture and supply of equipment of the same nature.


4. Funding :

The services covered by this request for quotation will be financed by the investment budget of the Centre National de Transfusion Sanguine (NBTS) for the 2024 financial year under the following allocation 58-40-047-06-350039-464110.

5. Submission method

The submission method chosen for this request for quotation shall be offline.

6. Consultation of the Request for Quotation File

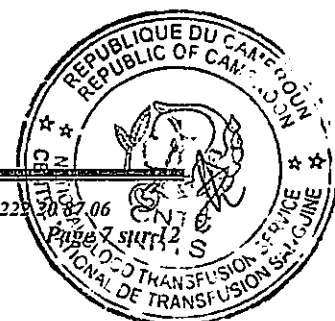

11. Opening of bids

The opening of the bids shall be done in one step and will take place on August 26th at 12 noon by the Internal Contracts Award Commission of the National Blood Transfusion Service in the hall dedicated to the deliberations of this technical support organ located in Yaounde, before the Bastos roundabout, precisely at the John Paul II Boulevard, P.O. Box 33165 Yaounde - Tel. : +237 222 208 706/222 208 383

Only bidders may attend this opening session or they can be represented by a duly mandated person of their choice. Under penalty of rejection, the required documents of the administrative file must be produced in originals or certified copies by the issuing service or competent administrative authority in accordance with the stipulations of the Special Regulations of the Consultation. They must be less than three (03) months old or must have been drawn up after the date of signature of the Quotation Notice.

In the event of the absence or non-conformity of a document from the administrative file during the opening of the tenders, after a period of grace of 48 hours granted by the Commission, the tender will be rejected.

The opening of the counting session must be done no later than one hour after the deadline for receipt of quotations set in the Request for Quotation File.

12. Admissibility of Quotations

The administrative documents, the technical and financial quotations must be in separate envelopes and must be sealed during submission. The following shall be inadmissible by the Contracting Authority :

- Envelopes bearing any information on the identity of the bidder ;
- Envelopes received after the deadlines for submission ;
- Envelopes that do not comply with the submission method ;
- Envelopes that do not clearly specify the Request for Quotation ;
- Failure to comply with the number of copies indicated in the Quotation Request or bid presented only in copies.

Any offer that is incomplete in accordance with the provisions of the Quotation Request will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue the bonds in the area of public contracts or non-compliance with the models of the documents of the Quotation Request, will lead to the outright rejection of the quotation without any recourse. A bid bond produced but unrelated to the consultation concerned shall be considered as absent or missing. A bid bond presented by a bidder during the bidding session shall be inadmissible.


13. Evaluation Criteria :

There are two types of evaluation criteria : eliminatory criteria and essential criteria. A criterion cannot be both eliminatory and essential.

13.1. Elimination criteria


These include :

- i. Incomplete or non-compliant administrative file after expiry of the 48-hour time limit;
- ii. Absence or non-conformity of the bid bond;

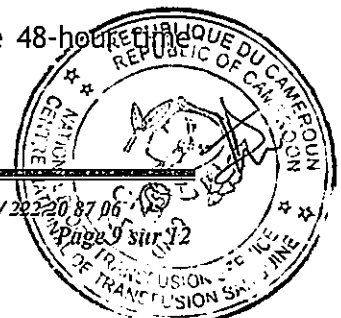

- iii. Absence of a declaration on honour that a contract has not been abandoned in the last three years;
- iv. false declarations, fraudulent maneuvers or falsification of documents;
- v. non-compliance with 80% of the essential criteria
- vi. absence of a quantified unit price in the quotation;
- vii. absence of an element of the financial offer (bid, BPU, DQE);
- viii. non-conformity of the bid model;
- ix. absence of prospectus in color accompanied by manufacturer's technical data sheets;
- x. absence of MINSANTE approval
- xi. absence of certificate of origin or manufacturer's authorization;
- xii. non-conformity of bidding method;
- xiii. absence of dated and signed integrity charter;
- xiv. absence of dated and signed declaration of commitment to environmental and social clauses;
- xv. non-acceptance of the clauses of the letter-order;
- xvi. non-compliance with major technical specifications of the supply :

| No | DESCRIPTION | Major technical specifications |
|----|--|--|
| 1 | 01 Thermostatically controlled water bath/bain-marie | Cyclotron Frequency Range 0: 20-300rpm/min Temperature range: RT-100°C |
| 2 | 02 plasma separators | Volume of the bags: 100- 400ml |
| 3 | 01 LED trinocular Microscope | Trinocular microscope (with 03 heads) |
| 4 | 03 Micropipettes: 10-100 microns (01), 100-200 microns (01), 100-1000 microns (01) | Volume from 10 to 100 µl |
| | | Volume from 20 to 200 µl |
| | | Volume from 100 to 1000 µl |
| 5 | 01 Blood Bank Refrigerator | Setpoint temperature: 4±2°C |
| | | Accuracy: 0.1°C |
| | | Low/high temperature alarm |
| | | Microprocessor system control |
| 6 | 01 Plasma freezer; | Plasma freezer 528 L |
| | | High temperature variation less than or equal to -20°C Low temperature -40°C |
| 7 | 01 Platelet agitator with cabinet | Temperature Variation: 22 °C ± 2 °C. |
| | | Temperature display error: ± 1 °C |
| | | Single Door |
| 8 | 02 Fixed blood bag tube welders | Sealing of blood bags avoiding haemolysis |
| | | Seal Type: Automatic |

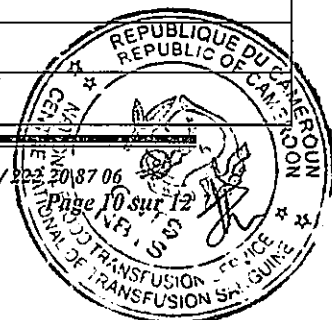

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 9 | 02 mobile blood bag tube welders | Soldering pliers with cable and battery charger |
| | | Autonomy : 1000 welds |
| 10 | 03 Hemo-mixer | Personalized blood collection volume |
| | | Measuring range : 0- 1200ml |

13.2. Essential criteria

The essential criteria for the qualification of bidders will relate to the following :

1. offer presentation ;
2. Experience in similar services;
3. after-sales service (availability of spare parts, repair workshop, technical staff), if applicable;
4. Attestation of financial capacity at least equal to the projected cost (incl. VAT) of the request for quotation, issued by an approved first-rate bank;
5. Delivery schedule and deadline not exceeding sixty (60) days;
6. Guarantee of at least six (06) months.

14. Estimated time frame for execution

The maximum period provided for by the Contracting Authority for the performance of the services covered by this Request for Quotation is sixty (60) calendar days. This period runs from the date of notification of the service order to start the services.

15. Slots/Allotment

The services that are the subject of this Request for Quotation are neither broken down nor allotted.

16. Award of Contract

The Contracting Authority will issue the purchase order to the bidder who submitted an offer that meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is considered as the lowest, including, where applicable, the proposed discounts.


17. Period of validity of offers

Bidders remain committed to their Quotations for sixty (60) days from the deadline set for the submission of bids.

18. Additional information

Any further information may be obtained during working hours at the Contracts Award Service of the National Blood Transfusion Service (NBTS), located in Yaounde, at the Head Office of the NBTS, P.O. Box 33165 Yaounde - Tel. : +222,208,383/222,208.706, or online at the following addresses : <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>


19. Fight Against Corruption and Malpractice

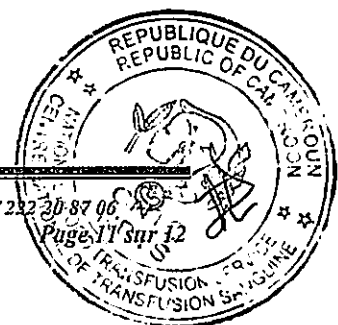

To report suspicious practices, events or actions, attempted corruption or malpractice, please call CONAC at 1517, the Authority in charge of public contracts (MINMAP) SMS or call the following numbers : (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48

Done in Yaounde, on 29 JUN 2024

The General Manager

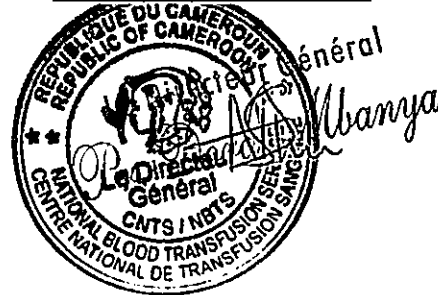

COPIED :

- MINMAP/ATCR ;
- ARMP for publication in Public Contracts Journal ;
- Chairperson/CIPM/info ;
- Posting ;
- Chrono/Archives.