

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/HGY/CIPM/25
DU 10 OCTOBRE 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE
ET L'INSTALLATION D'UN SCANNER 128 BARRETTES, LA REPARATION, LA
MAINTENANCE, LA REHABILITATION ET LA REMISE EN FONCTIONNEMENT
DU SCANNER SOMATOM GO TOP DANS LE SERVICE D'IMAGERIE
MEDICALE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public MINSANTE - Exercice 2025

IMPUTATIONS BUDGETAIRES :

- CHAP 40, Programme 047, Action 06, Code 340050 464102
- CHAP 40, Programme 047, Action 08, Code 340020 464102

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé lance un Appel d'Offres national Ouvert en Procédure d'Urgence pour la fourniture et l'installation d'un (01) scanner de 128 barrettes d'une part et la réparation, la maintenance, la réhabilitation et la remise en fonctionnement du scanner SOMATOM GO TOP d'autre part dans le service d'imagerie médicale de l'HGY.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent appel d'offres comprennent la fourniture et l'installation d'un (01) scanner de 128 barrettes et la réparation, la maintenance, la réhabilitation et la remise en fonctionnement du scanner SOMATOM GO TOP.

3. Allotissement

Le présent appel d'offres est regroupé en deux (02) lots :

- Lot 1 : fourniture et l'installation d'un (01) scanner de 128 barrettes ;
- Lot 2 : la réparation, la maintenance, la réhabilitation et la remise en fonctionnement du scanner SOMATOM GO TOP

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel total à l'issue des études préalables est de F CFA 497 000 000 (Quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions) réparti comme suit :

LOTS	DESIGNATION	MONTANT PREVISIONNEL	TOTAL
Lot 1	Fourniture et l'installation d'un (01) scanner de 128 barrettes	400 000 000	Quatre cent millions
Lot 2	La réparation, la maintenance, la réhabilitation et la remise en fonctionnement du scanner SOMATOM GO TOP	97 000 000	Quatre-vingt-dix-sept millions
TOTAL		497 000 000	Quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions

5. Délai de livraison

Le délai maximum de livraison des fournitures prévu par le Maître d'Ouvrage est de quatre (04) semaines à partir de la date de notification de l'ordre de service.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est réservée aux entreprises installées au Cameroun ou à l'étranger ayant une expérience dans la fourniture de ce type de fournitures.

7. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget d'investissement Public du MINESANTE-Exercice 2025.

IMPUTATIONS BUDGETAIRES :

- CHAP 40, Programme 047, Action 06, Code 340050 464102 (lot 1) ;
- CHAP 40, Programme 047, Action 08, Code 340020 464102 (lot 2).

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne

9. Cautionnement de soumission

- Lot 1 : 5 000 000 (cinq millions) Francs CFA ;
- Lot 2 : 1 000 000 (un million) Francs CFA.

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) et d'une durée de validité de trente (30) jours, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chèque certifié, chèque de banque, hypothèque légale) sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement; Le récépissé du dépôt du cautionnement provisoire délivré par la caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) où la preuve du virement du compte du soumissionnaire au compte de la CDEC du montant équivalent à ladite caution par l'établissement bancaire de cette caution provisoire.

A cette caution devra être jointe le récépissé de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDEC) d'un montant égal à celui du cautionnement.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au niveau de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, B.P. : 5408 Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses email : <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de FCFA 200 000 (deux cent) pour le lot 1 et FCFA 50 000 (cinquante mille) pour le lot 2, payable au compte n°335988 ouvert au nom de « Compte Spécial CAS- ARMP » à la BICEC de Yaoundé.

Il est également possible d'obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Remise des offres

L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique officiel à préciser par le maître d'ouvrage au plus tard le 07 Novembre 2025 à 13 heures précises, heure locale.

Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/HGY/CIPM/25

DU 10 OCTOBRE 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'UN
SCANNER 128 BARRETTES, LA REPARATION, LA MAINTENANCE, LA REHABILITATION ET LA REMISE EN
FONCTIONNEMENT DU SCANNER SOMATOM GO TOP DANS LE SERVICE D'IMAGERIE MEDICALE DE
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE »

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le Dossier Administratif ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission
- le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des offres (administratives, techniques et financières) aura lieu le 07 Novembre 2025 à 14 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de l'Hôpital Général de Yaoundé dans la Salle des réunions de la Direction Générale de l'Hôpital Général de Yaoundé.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale

de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. Critères d'évaluation

15.1 Critères éliminatoires

Lot n° 1 : fourniture et l'installation d'un (01) scanner de 128 barrettes

- a. L'absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé CDEC ;
- b. La non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
- c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces
- d. Non satisfaction à 70% des critères essentiels ;
- e. L'absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produit par le fabricant ;
- f. L'absence de l'agrément du MINSANTE
- g. Absence de l'autorisation délivrée par le fabricant
- h. L'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
- i. L'absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années
- j. L'absence de la lettre de soumission.
- k. L'absence de la charte d'intégrité
- l. L'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental
- m. Le non-respect du format de fichiers des offres
- n. Absence du certificat de conformité du fabricant (ISO ICUNET...)
- o. Absence de l'attestation de visite de site signée sur l'honneur
- p. Critères majeurs pour le lot 1(Acquisition et installation d'un scanner)

1. Non-respect de la composition de l'unité de scanner :

- Un scanner 128 barrettes,
- Un injecteur de produit de contraste,
- Un reprographe Laser,
- Un stabilisateur de tension de compensation,
- Un onduleur,
- Une armoire électrique de protection.

2. Non-respect de la conformité du support patient

- Mouvement longitudinal :
 - Variation : 0 - 1750 mm,
 - Plage de numérisation : 0 - 1700 mm,
 - Vitesse : 0,1 - 460 mm/s,
 - Précision de positionnement : $\pm 0,25$ mm,
- Mouvement vertical :
 - Portée : 430 - 970 mm au-dessus du sol,
 - Incrémentation de 1,0
- Capacité de charge du support patient : 205 kg minimum,
- Construction du plateau flottant : Fibre de carbone,
- Configuration : Pédale et boutons poussoirs de deux côtés pour une libération rapide du patient.

3. Non-respect de la conformité du tube à rayon X

- Tube dynamique à quatre points focaux ;
- Double acquisition de l'axe Z dans toutes les positions de projection ;
- Chevauchement de la demi-largeur du détecteur permettant la réalisation d'un échantillonnage de 256 tranches ;
- Capacité de stockage de chaleur de l'anode du tube : 30MHU maximum ;
- Taux de refroidissement : 20kw/ min minimum ;
- Taille du focal : 0.6 × 1.2 (Petit), 1.1 × 1.2 Grand ;
- Quadruple échantillonnage

4. Non-respect de la conformité du générateur

- Technologie d'anneau glissant basse tension ;
- Puissance : 100 KW minimum ;
- Tensions du tube : 60kV, 70kV, 80kV, 100kV, 120kV, 140kV ;
- Intensité : 10mA - - - 830mA minimum,

5. Non-respect de la conformité du système de stockage des images radiologiques :

- Un ordinateur d'imagerie médicale centrale avec système de traitement de données multitâches ;
- Mémoire vive : 4 GO minimum ;
- Une console de commande avec clavier alphanumérique
- Capacité du disque dur : 750 GO minimum ;
- Capacité de stockage d'images compressées : 960 000 minimum,
- Matrice d'images : 512x512 au moins,
- Mode stockage : CD/DVD,
- Le système doit comprendre des logiciels de gestion, de contrôle, de traitement de l'image et la reconstruction en 3 dimensions,

6. Non-respect de la conformité du stabilisateur de tension de compensation

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 120kVA (cette puissance sera fonction de celle de l'équipement proposé)
- Triphasé,
- Affichage numérique des paramètres,
- Sortie :
 - Précision de régulation de tension : $380V \pm 4\%$,
 - Protection contre les sous-tensions : $340V \pm 7V$,
 - Protection contre les surtensions $420V \pm 7V$,
 - Plage de tension d'entrée 280 ~ 415V,
- Efficacité 90%,
- Régulation de la tension <1 s (lorsque la tension d'entrée change de 10%),
- Fréquence 50 / 60Hz

7. Non-respect de la conformité de l'onduleur

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 120kVA (cette puissance sera fonction de celle de l'équipement proposé)
- Topologie UPS : Double conversion en ligne,
- Architecture de l'ACI :
 - Autonome,
 - Sans transformateur,
 - En parallèle sur site,
- In/out phase de configuration : Triphasé-triphasé,
- Neutre : Transit neutre,
- Forme d'onde de sortie sur le fonctionnement du réseau : Sinusoïdal,
- Forme d'onde de sortie sur le fonctionnement de la batterie : Sinusoïdal

Entrée :

- Tension nominale : 400 3ph+N+PE,
- Niveau de tension :
 - 338 - 459 Ph-Ph pleine charge,
 - 208 - 459 Ph-Ph demi-charge,
- Fréquence 45 - 65Hz

Bypass

- Tension nominale : 380/400/415V,
- Plage de tension : -18% +15% (réglable),

- Fréquence : 47-53 (réglable) ou 57-63 (réglable),
- Type de bypass : Statique et électromécanique,
- Le temps de transfert : Zéro,
- Bypass manuel : Encastré

Sortie sur secteur (CA-CA) :

- Tension nominales : 380, 400, 415 3ph+N+PE,
- Puissance nominale : 120.000 VA minimum (elle sera fonction de l'équipement proposé),
- Puissance active : 108.000 W minimum (elle sera fonction de l'équipement proposé),
- Variation de voltage (statique) : $\pm 1\%$,
- Fréquence : 50 Hz ou 60 Hz (sélectionnable)

Sortie à l'opération de la batterie (DC-AC) :

- Tension nominale : 380, 400, 415 3ph+N+PE (elle sera fonction de l'équipement proposé),
- Puissance nominale : 120.000 VA minimum (elle sera fonction de l'équipement proposé),
- Puissance active : 108.000 W minimum (elle sera fonction de l'équipement proposé),
- Variation de tension (statique) $\pm 1\%$,
- Fréquence 50 Hz or 60 Hz (sélectionnable),
- Fréquence tolérée $\pm 0,01\%$ free run.

Batterie :

- Type VRLA Plomb acide, étanche, sans entretien,
- Capacité de l'unité 7 ou 9 Ah (12V),
- Tension nominale de la batterie UPS : ± 360 V CC,
- Type du chargeur de batterie : Le redresseur IGBT charge également les batteries,
- Courant max de charge sans déclassement 8 A

8. Non-respect de la conformité de l'armoire électrique de protection

L'armoire électrique proposée sera équipée d'appareillages modulaires, dimensionnés et calibrés en fonction du bilan de puissance des équipements proposés.

Caractéristiques techniques :

- Coffret métallique conçu avec des plaques d'acier laminées à froid,
- Epaisseur des plaques : 2mm minimum,
- Couverture : peinture époxy polyester,
- Porte Métallique opaque,
- Type de serrure : 01 Serrure.

Lot n°2 : la réparation, la maintenance, la réhabilitation et la remise en fonctionnement du scanner SOMATOM GO TOP

- a) L'absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé CDEC ;
- b) La non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
- c) Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces
- d) Non satisfaction à 70% des critères essentiels ;
- e) L'absence de l'agrément du MINSANTE
- f) Absence de l'autorisation délivrée par le fabricant
- g) L'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
- h) L'absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années
- i) L'absence de la lettre de soumission.
- j) L'absence de la charte d'intégrité
- k) L'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental
- l) Le non-respect du format de fichiers des offres
- m) Absence du certificat de conformité du fabricant (ISO ICUNET...)
- n) Absence de l'attestation de visite de site signée sur l'honneur,
- o) Non-respect de la conformité de l'ensemble tube à rayon x et son système de refroidissement
- p) Fabricant : siemens healthcare gmbh

- q) Désignation : scanner somatom go top
- r) Modèle : (240) 11061640
- s) Numéro de série : (21) 119172
- t) Gantry (tube) hp4 fo
- u) Modèle : (240) 11101874
- v) Numéro de série : (21) 1172
- w) Absence de l'engagement sur l'honneur du prestataire de livrer l'équipement réparé et maintenu fonctionnel dans toutes ses fonctions avec une garantie de 06 (six) mois sur les pièces de rechanges livrées et installées et 01 (un) an de garantie sur la main d'œuvre

15.2 Critères essentiels

Lot n° 1 : fourniture et l'installation d'un (01) scanner de 128 barrettes

L'évaluation des offres technique sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

- Non-respect de la conformité de la console secondaire (fonctionnalités, logiciels et matériel) voir détails pièce N°5 : spécifications techniques
- Non-respect la conformité du système de gestion de données patients :
Le système de gestion des données des patients comprendra :
 - L'inscription des patients,
 - L'horaire,
 - Archivage/modification/suppression/recherche des informations.
- Non- respect de la conformité de la gestion et archivage des images (voir pièce 5 : spécifications techniques),
- Absence du système de traitement d'images (voir détails pièce 5 cahier des spécifications techniques),
- Non-respect de la conformité du reprographe (voir détails pièce 5 cahier des spécifications techniques),
- Non-conformité des logiciels spécifiques (voir détails pièce 5 cahier des spécifications techniques)
- La présentation de l'offre ;
- Les références du soumissionnaire ;
- Le délai de garantie ;
- Le calendrier de livraison ;
- La capacité financière ;
- La preuve d'acceptation des conditions du marché ;
- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, personnel technique) ;
- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
- La qualification et l'expérience du personnel.

Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% OUI seront jugés techniquement qualifiés pour ce lot et admis à l'analyse financière.

Lot n°2 : la réhabilitation et remise en service du scanner SIEMENS SOMATOM GO TOP

L'évaluation des offres technique sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

- Non-respect de la conformité de la consistance des travaux (voir détails pièce 5 cahier des spécifications techniques),
- La présentation de l'offre ;
- Les références du soumissionnaire ;
- Le délai de garantie ;
- Le calendrier de livraison ;
- La capacité financière ;
- La preuve d'acceptation des conditions du marché ;
- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, personnel technique) ;
- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;

- La qualification et l'expérience du personnel.

Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% OUI seront jugés techniquement qualifiés pour ce lot et admis à l'analyse financière

16. Attribution du marché

Le marché sera attribué au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant. Un soumissionnaire peut être attributaire d'un (01) ou de deux (02) lots.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables Secrétariat de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage.

19. Dispositions relatives à la lutte contre la corruption


Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48

Yaoundé le 10 Octobre 2025.

LE DIRECTEUR GENERAL

Ampliations :

- MINMAP
- ARMP (for publication)
- DG/HGY
- President CIPM-HGY (for information)
- DAAF/HGY
- Posting (for information)

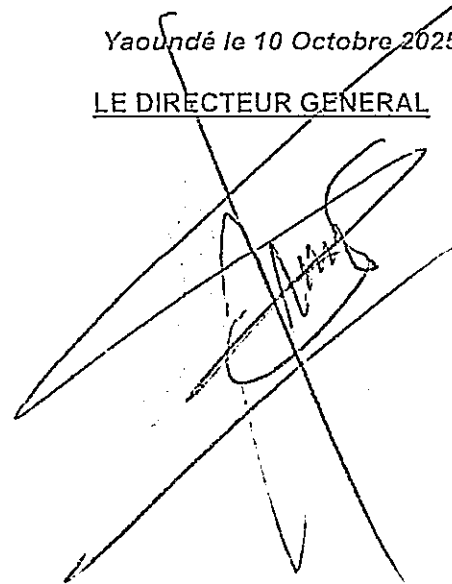



YAOUNDE GENERAL HOSPITAL (YGH)

NATIONAL OPEN CALL FOR TENDER NO. 008/AONO/HGY/CIPM/25

DATED 10 OCTOBER 2025 UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF A 128-STRIP SCANNER, THE REPAIR, MAINTENANCE, REHABILITATION AND RESTORATION OF THE SOMATOM GO TOP SCANNER IN THE MEDICAL IMAGING DEPARTMENT OF THE YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

FINANCING: MINSANTE Public Investment Budget - 2025 Fiscal Year

BUDGET CHARGE:

- CHAP 40, Program 047, Action 06, Code 340050 464102.
- CHAP 40, Program 047, Action 08, Code 340020 464102.

1. Purpose of the Call for Tenders

The Director General of the Yaoundé General Hospital is issuing a National Open Call for Tenders under Emergency Procedure for the supply and installation of one (01) 128-strip scanner and the repair, maintenance, rehabilitation and restoration of the SOMATOM GO TOP scanner in the Medical Imaging Department of the Yaoundé General Hospital .

2. Scope of Services

The services provided under this call for tenders include the supply and installation of one (01) 128-strip scanner and the repair, maintenance, rehabilitation and restoration of the SOMATOM GO TOP scanner.

3. Subdivision

This call for tenders is divided into two (02) lots:

- Lot 1: Supply and installation of one (01) 128-strip scanner;
- lot 2: the repair, maintenance, rehabilitation and restoration of the SOMATOM GO TOP scanner.

4. Estimated Cost

The total estimated cost following preliminary studies is F CFA 497,000,000 (Four hundred and ninety-seven million) broken down as follows:

LOTS	DESIGNATION	PROJECTED AMOUNT	TOTAL
Lot 1	Supply and installation of one (01) 128-strip scanner	400 000 000	Four hundred million
Lot 2	the repair, maintenance, rehabilitation and restoration of the SOMATOM GO TOP scanner	97 000 000	Ninety-seven million
TOTAL		497 000 000	Four hundred million Ninety-seven

5. Delivery Time

The maximum delivery time for supplies, as stipulated by the Project Owner, is four (04) weeks from the date of notification of the service order.

6. Participation and Origin

Participation in this call for tenders is reserved for companies established in Cameroon or abroad with experience in supplying this type of supply.

7. Financing

The services covered by this call for tenders are financed by the Ministry of Public Health Public Investment Budget:

- CHAP 40, Program 047, Action 06, Code 340050 464102 (lot 1)
- CHAP 40, Program 047, Action 08, Code 340020 464102 (lot 2).

8. Submission Method

The submission method chosen for this consultation is online.

9. Bid Bond

- Lot 1 : 3 000 000 (Three millions) Francs CFA ;
- Lot 2 : 1 000 000 (one million) Francs CFA.

Each bidder must attach to its administrative documents a bid bond paid by hand (according to the attached model) and valid for thirty (30) days, issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized by the Ministry of Finance of Cameroon to issue bonds in the context of public procurement or any other form provided for by the regulations in force (certified check, bank check, legal mortgage) unless otherwise provided for in the financing agreement; The receipt for the deposit of the provisional bond issued by the Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) or proof of transfer from the bidder's account to the CDEC account of the amount equivalent to said bond by the banking institution of this provisional bond.

This bond must be attached to the receipt from the Caisse de Dépôt et de Consignation (CDEC) for an amount equal to that of the bond.

10. Consultation of the Tender Documents

The documents may be consulted during business hours at the SIGAMP office of the Yaoundé General Hospital, P.O. Box 5408 Yaoundé, Tel.: 222 20 39 53, Fax: 222 21 20 15, upon publication of this notice.

It may also be consulted online on the COLEPS platform at the following email addresses: <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the ARMP website (www.armac.cm).

11. Acquisition of the Tender Documents

The documents may be obtained from the SIGAMP office of the Yaoundé General Hospital, Tel.: 222 20 39 53, fax: 222 21 20 15 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of one hundred thousand (200,000) FCFA payable to account no. 635988 opened in the name of "CAS-ARMP Special Account" at BICEC in Yaoundé. It is also possible to obtain the electronic version of the DAO by free download from the addresses indicated above. However, submission by physical or electronic means is conditional upon payment of the DAO purchase fee.

12. Submission of Bids

The bid must be submitted by the bidder via the COLEPS platform or any other official electronic means of communication to be specified by the project owner no later than 1:00 p.m. local time on October, 07th 2025.

A backup copy of the bid, saved on a USB flash drive or CD/DVD, must be submitted in a sealed envelope with the clear and legible indication "backup copy," in addition to the statement below, within the specified timeframe. "

NATIONAL OPEN CALL FOR TENDER NO. 008/AONO/HGY/CIPM/25

DATED 10 OCTOBER 2025 UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF A 128-STRIP SCANNER, THE REPAIR, MAINTENANCE, REHABILITATION AND RESTORATION OF THE SOMATOM GO TOP SCANNER IN THE MEDICAL IMAGING DEPARTMENT OF THE YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

The maximum file sizes for documents submitted on the platform and constituting the bidder's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative File;

- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are as follows:

- PDF format for text documents;
- JPEG for images.

The candidate must use compression software to reduce the size of the files to be submitted.

13. Admissibility of Bids

The administrative documents, the technical bid, and the financial bid must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The following will not be accepted by the Project Owner:

- Bids bearing information on the bidders' identities,
- Bids received after the submission deadlines.
- Bids without information on the identity of the Call for Tenders;
- Bids that do not comply with the submission method.
- Failure to comply with the number of copies indicated in the RPAO or offering only copies.

Any bid that is incomplete in accordance with the requirements of the Call for Tenders Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a first-class organization or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public procurement, or failure to comply with the models of the documents in the Call for Tenders Documents, will result in the outright rejection of the offer without any recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation in question is considered absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

14. Opening of Bids

The bids will be opened in one step.

The opening of bids (administrative, technical, and financial) will take place on October, 07-2025 at 2:00 p.m. local time by the Internal Procurement Committee of the Yaoundé General Hospital in the meeting room of the General Management of the Yaoundé General Hospital.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be submitted in original form or in copies certified by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old from the original bid submission date or have been prepared after the date of signature of the call for tenders.

In the event of absence or non-compliance of a document in the administrative file when the bids are opened after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

15. Evaluation Criteria

15.1 Elimination Criteria

- Absence of a bid bond accompanied by the CDEC receipt;
- Failure to produce, beyond the 48-hour deadline after bid opening, an administrative file document deemed non-compliant or missing at the time of bid opening (except for the bid bond);
- False declarations, fraudulent practices, or falsification of documents
- Failure to meet 70% of the essential criteria;
- Absence of a brochure, catalog, drawing, or technical data sheet produced by the manufacturer;
- Absence of Ministry of Public Health approval
- Absence of authorization issued by the manufacturer
- Absence of a quantified unit price in the Financial Offer;
- Absence of a sworn statement of not having abandoned a construction site during the last three (03) years
- Absence of the letter of submission.
- Absence of an integrity charter
- Absence of a social and environmental commitment statement
- Failure to comply with the bid file format

n. Absence of a manufacturer's certificate of conformity (ISO ICUNET, etc.)

p. Major criteria for Lot 1 (Acquisition and installation of a scanner)

1. Failure to comply with the composition of the scanner unit:

- A 128-strip scanner,
- A contrast agent injector,
- A laser reprographer,
- A compensation voltage stabilizer,
- An inverter,
- A protective electrical cabinet.

2. Patient support compliance failure

- Longitudinal movement:
 - Variation: 0 - 1750 mm,
 - Scanning range: 0 - 1700 mm,
 - Speed: 0.1 - 460 mm/s,
 - Positioning accuracy: ± 0.25 mm,
- Vertical movement:
 - Range: 430 - 970 mm above the floor,
 - Increment of 1.0,
- Patient support load capacity: Minimum 205 kg,
- Floating table construction: Carbon fiber,
- Configuration: Foot pedal and push buttons on both sides for quick patient release.

3. X-ray tube compliance failure

- Dynamic tube with four focal points;
- Dual Z-axis acquisition in all projection positions;
- Detector half-width overlap allowing for 256-slice sampling;
- Tube anode heat storage capacity: 30 MHU maximum;
- Cooling rate: 20 kW/min minimum;
- Focal size: 0.6×1.2 (Small), 1.1×1.2 (Large);
- Quadruple sampling

4. Generator compliance failure

- Low-voltage slip ring technology;
- Power: 100 kW minimum;
- Tube voltages: 60 kV, 70 kV, 80 kV, 100 kV, 120 kV, 140 kV;
- Intensity: 10mA - - - - 830mA minimum,

5. Non-compliance with the compliance of the radiological image storage system:

- A central medical imaging computer with a multitasking data processing system;
- RAM: 4 GB minimum;
- A control console with an alphanumeric keyboard
- Hard drive capacity: 750 GB minimum;
- Compressed image storage capacity: 960,000 minimum,
- Image matrix: 512×512 minimum,
- Storage mode: CD/DVD,
- The system must include software for management, control, image processing, and 3D reconstruction,

6. Non-compliance with the voltage compensation stabilizer

Technical specifications:

- Power: 120kVA (this power will depend on the proposed equipment)
- Three-phase
- Digital parameter display
- Output:
 - Voltage regulation accuracy: $380V \pm 4\%$
 - Undervoltage protection: $340V \pm 7V$
 - Overvoltage protection: $420V \pm 7V$
 - Input voltage range: 280 ~ 415V
- Efficiency: 90%
- Voltage regulation time < 1 s (when the input voltage changes by 10%),
- Frequency: 50/60Hz

7. Non-compliance with UPS compliance

Technical specifications:

- Power: 120kVA (this power will depend on the proposed equipment)
- UPS topology: Online double conversion
- UPS architecture:
 - Standalone
 - Transformerless
 - On-site parallel
- In/Out configuration phase: Three-phase-three-phase
- Neutral: Neutral transit
- Output waveform on grid operation: Sinusoidal
- Output waveform on battery operation: Sinusoidal

Input:

- Nominal voltage: 400 3ph+N+PE
- Voltage level:
 - 338 - 459 Ph-Ph full load
 - 208 - 459 Ph-Ph half load
- Frequency: 45 - 65Hz

Bypass

- Nominal voltage: 380/400/415V,
- Voltage range: -18% +15% (adjustable),
- Frequency: 47-53 (adjustable) or 57-63 (adjustable),
- Bypass type: Static and electromechanical,
- Transfer time: Zero,
- Manual bypass: Flush-mounted

Mains Output (AC-AC):

- Nominal voltages: 380, 400, 415 3ph+N+PE,
- Nominal power: 120,000 VA minimum (depending on the equipment offered),
- Active power: 108,000 W minimum (depending on the equipment offered),
- Voltage variation (static): $\pm 1\%$,
- Frequency: 50 Hz or 60 Hz (selectable)

Battery operating output (DC-AC):

- Nominal voltage: 380, 400, 415 3ph+N+PE (depending on the equipment offered),
- Nominal power: 120,000 VA minimum (depending on the equipment offered),
- Active power: 108,000 W minimum (depending on the equipment offered),
- Voltage variation (static) $\pm 1\%$,
- Frequency 50 Hz or 60 Hz (selectable),
- Permissible frequency $\pm 0.01\%$ free run.

Battery:

- VRLA type: Sealed, maintenance-free lead acid,
- Unit capacity: 7 or 9 Ah (12V),
- UPS battery nominal voltage: ± 360 V DC,
- Battery charger type: The IGBT rectifier also charges the batteries,
- Maximum charge current without derating: 8 A

8. Failure to comply with the electrical protection cabinet's compliance

The proposed electrical cabinet will be equipped with modular devices, sized and calibrated according to the power requirements of the proposed equipment.

Technical specifications:

- Metal enclosure made of cold-rolled steel plates,
- Plate thickness: 2 mm minimum,
- Cover: epoxy polyester paint,
- Opaque metal door,
- Lock type: 01 Lock.

Lot No. 2: Repair, maintenance, rehabilitation, and recommissioning of the SOMATOM GO TOP scanner

- a) Absence of a bid bond accompanied by the CDEC receipt;
- b) Failure to produce, beyond the 48-hour deadline after bid opening, an administrative file document deemed non-compliant or missing at the time of bid opening (except for the bid bond);
- c) False declarations, fraudulent practices, or falsification of documents
- d) Failure to meet 70% of the essential criteria;
- e) Absence of MINSANTE approval
- f) Absence of authorization issued by the manufacturer

- g) Absence of a quantified unit price in the Financial Offer; ~~or~~ Lack of a sworn statement stating that no construction site has been abandoned in the last three (03) years
- h) Lack of a submission letter
- i) Lack of an integrity charter
- j) Lack of a social and environmental commitment statement
- k) Failure to comply with the bid file format
- l) Lack of a manufacturer's certificate of conformity (ISO ICUNET, etc.)
- n) Absence of a signed site visit certificate,
- o) Non-compliance with the conformity of the X-ray tube assembly and its cooling system
- p) Manufacturer: Siemens Healthcare GmbH
- q) Designation: SOMATOM GO TOP SCANNER
- r) Model: (240) 11061640
- s) Serial number: (21) 119172
- t) Gantry (tube) HP4 fo
- u) Model: (240) 11101874
- v) Serial number: (21) 1172
- w) Absence of a sworn commitment by the service provider to deliver the equipment repaired and maintained in full functional condition, with a six-month warranty on spare parts delivered and installed and a one-year warranty on labor.

15.2 Essential Criteria

The technical bids will be evaluated using a binary system (yes/no) based on the following essential qualification criteria:

- Presentation of the offer;
- Bidder's references;
- Warranty period;
- Delivery schedule;
- Financial capacity;
- Proof of acceptance of contract terms;
- After-sales service (availability of spare parts, technical personnel);
- Access to a line of credit or other financial resources;
- Personnel qualifications and experience.

Only bidders who obtain at least 70% "YES" will be deemed technically qualified for this lot and will be admitted to the financial analysis.

16. Contract Award

The contract will be awarded to the Bidder whose offer has been found to be substantially compliant with the Tender Documents and who has the technical and financial capacity required to perform the contract satisfactorily and whose offer has been evaluated as the lowest priced after applying any proposed discounts.

A bidder may be awarded one (01) or two (02) lots.

17. Bid Validity

Bidders remain bound by their bid for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.


18. Additional Information

Additional information may be obtained during business hours at [service (SIGAMP), door number, PO Box, telephone, fax, email] or online on the COLEPS platform at: <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, or by any other electronic means of communication indicated by the Contracting Authority.

19. Provisions relating to the fight against corruption

To report any practices, facts, or acts of corruption, please call CONAC at 1517, or the Public Procurement Authority (MINMAP) (text-message or call) at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

THE GENERAL MANAGER

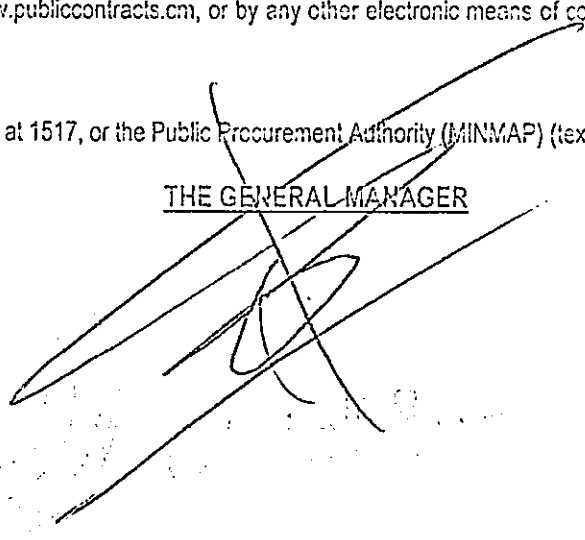

Copies to:

- MINMAP
- ARMP (for publication)
- DG/HGY
- ARMP/ CE
- President CIPM-HGY (for information)
- DATF/HGY
- Posting (for information)